

検査内容変更 及び 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記の項目につきまして、検査内容の変更及び検査の受託中止をさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 検査内容の変更 (📄 3 ページ)

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内2026 掲載ページ
04267	ホモシステイン	3
13648	抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル)	67,123

変 更 日 2026年10月1日(木) ご依頼分より

● 報告書の一部変更 (📄 5 ページ)

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内2026 掲載ページ
13612	マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患)	150

変 更 日 2026年10月1日(木) 報告分より

● 検査の受託中止 (📄 6 ページ)

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内2026 掲載ページ
13228	尿中シュウ酸	5
00499	アルドラーゼ(ALD)	10
00430	イオン化カルシウム	15
02722	UBT/ピロニック(尿素呼気試験)	76
13271	リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法)	112
13738	肺癌KRAS G12C変異解析	163
03546	HDL _{2,3} コレステロール	229
07401	リポ蛋白脂質分画定量	229
07402	リポ蛋白コレステロール分画定量	229
07403	リポ蛋白トリグリセライド分画定量	229
07404	リポ蛋白リン脂質分画定量	229
04925	コレステリルエステル転送蛋白(CETP)定量/EIA	229
04432	可溶性ICAM-1	243

最終受託日 2026年9月30日(水) ご依頼分まで

検査内容の変更

● ホモシステイン

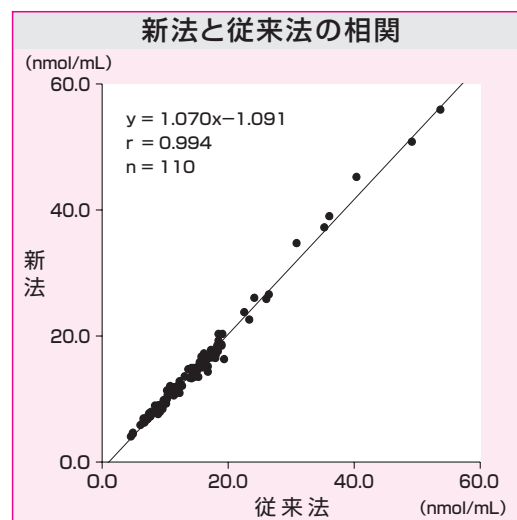
検査精度向上を目的として、検査方法を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検体必要量、所要日数、報告範囲を変更させていただきます。

	新	従来
依頼コード No.	04267	同左
検査項目名	ホモシステイン	同左
JLAC10コード	3C070-0000-022-205	3C070-0000-022-204
検体必要量	血漿 0.3mL	血漿 0.4mL
容器	B-7 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	4~5	5~11
検査方法	LC-MS/MS法	HPLC法
基準値	M:6.3~18.9 F:5.1~11.7	同左
単位	nmol/mL	同左
報告範囲	0.3未満~最終値	0.2以下~最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	279点/144点(生化学的検査(Ⅱ))	同左
備考	必ず採血後速やかに血漿分離し、プラスチック容器(S-1)に移してください。	同左

【検査方法の参考文献】

J. Magera M, et al.: Clin. Chem. 45, 1517-1522, 1999.



自社検討資料

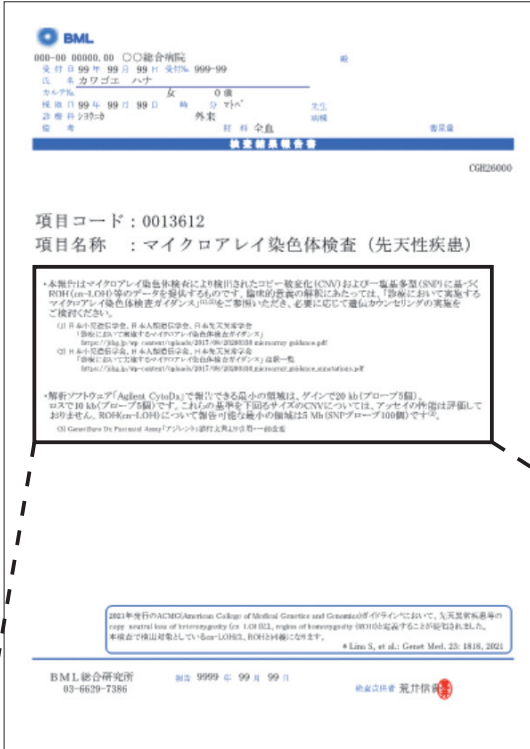
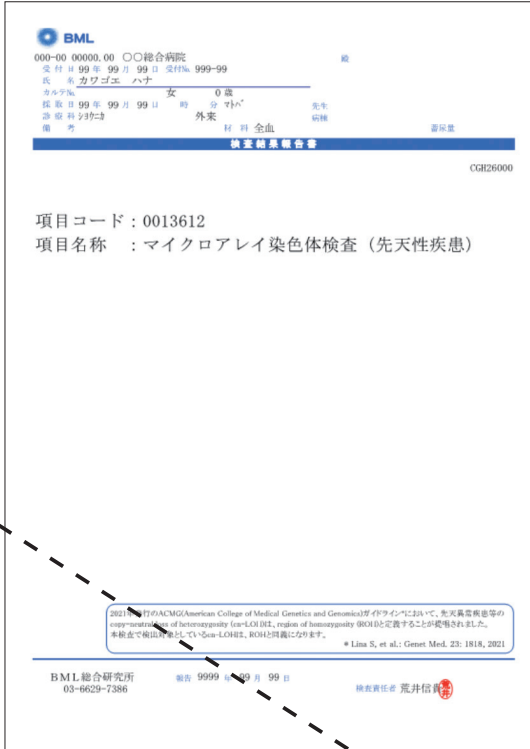
● 抗リン脂質抗体検査パネル（APS検査パネル）

検査内容の見直しにより、報告範囲を変更させていただきます。
 なお、この変更に伴う、他の受託要領の変更はございません。

	新	従来
検査項目名 及び 依頼（報告） コードNo.	13648(親)APS検査パネル ----- (子)22982 抗カルジオリピンIgG (子)22983 抗カルジオリピンIgM (子)22984 抗β2GP1 IgG (子)22985 抗β2GP1 IgM	同左 ----- 同左
JLAC10コード	5G519-0000-022-051	同左
検体必要量	血漿 0.5mL	同左
容器	B-11 → S-1	同左
検体の保存方法	凍結	同左
所要日数	2～4	同左
検査方法	CLIA法	同左
基準値	20.0以下	同左
単位	U/mL	同左
報告範囲	抗カルジオリピンIgG：2.6未満～2024.0以上 抗カルジオリピンIgM：1.0未満～774.0以上 抗β2GP1 IgG：6.4未満～6100.0以上 抗β2GP1 IgM：1.1未満～841.0以上	抗カルジオリピンIgG：2.6以下～2024.0以上 抗カルジオリピンIgM：1.0以下～774.0以上 抗β2GP1 IgG：6.4以下～6100.0以上 抗β2GP1 IgM：1.1以下～841.0以上
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	678点(226点×3)/144点(免疫学的検査)	同左

● マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患)

検査結果報告書(親展報告書)の鑑部に、「遺伝カウンセリングの必要性に関する記述」と「検出基準、報告基準」を追記いたします。

新	従来
 項目コード : 0013612 項目名称 : マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患) ・本報告はマイクロアレイ染色体検査により検出されたコピー数変化(CNV)および一塩基多型(SNP)に基づくROH(cn-LOH)等のデータを提供するものです。臨床的意義の解釈にあたっては、「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」^{(1),(2)}をご参照いただき、必要に応じて遺伝カウンセリングの実施をご検討ください。 (1) 日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会 「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」 https://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/20200330_microarray_guidance.pdf (2) 日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会 「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」注釈一覧 https://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/20200330_microarray_guidance_annotations.pdf ・解析ソフトウェア「Agilent CytoDx」で報告できる最小の領域は、ゲインで20 kb(プローブ5個)、ロスで10 kb(プローブ5個)です。これらの基準を下回るサイズのCNVについては、アッセイの性能は評価しておりません。ROH(cn-LOH)について報告可能な最小の領域は5 Mb(SNPプローブ100個)です⁽³⁾。 (3) GenetiSure Dx Postnatal Assay「アジレント」添付文書より引用・一部改変	 項目コード : 0013612 項目名称 : マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患)

- ・本報告はマイクロアレイ染色体検査により検出されたコピー数変化(CNV)および一塩基多型(SNP)に基づくROH(cn-LOH)等のデータを提供するものです。臨床的意義の解釈にあたっては、「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」^{(1),(2)}をご参照いただき、必要に応じて遺伝カウンセリングの実施をご検討ください。
- (1) 日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会
「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」
https://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/20200330_microarray_guidance.pdf
- (2) 日本小児遺伝学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会
「診療において実施するマイクロアレイ染色体検査ガイダンス」注釈一覧
https://jshg.jp/wp-content/uploads/2017/08/20200330_microarray_guidance_annotations.pdf
- ・解析ソフトウェア「Agilent CytoDx」で報告できる最小の領域は、ゲインで20 kb(プローブ5個)、ロスで10 kb(プローブ5個)です。これらの基準を下回るサイズのCNVについては、アッセイの性能は評価しておりません。ROH(cn-LOH)について報告可能な最小の領域は5 Mb(SNPプローブ100個)です⁽³⁾。
- (3) GenetiSure Dx Postnatal Assay「アジレント」添付文書より引用・一部改変

検査の受託中止

●代替項目あり

受託中止項目			代替項目	
依頼コードNo.	検査項目名	中止理由	依頼コードNo.	検査項目名
02722	UBT/ピロニック(尿素呼気試験) 使用診断薬 ピロニック	検査項目統合のため	03294	尿素呼気試験/IR法 使用診断薬 ユービット
13271	リンパ球幼若化・PHA (微量全血培養法)	受託数僅少のため	13269	リンパ球幼若化検査・PHA (分離培養法)
13738	肺癌KRAS G12C変異解析		13973	肺がんコンパクトパネルCDx 7遺伝子-FFPE
			77480	オンコメインマルチCDx 8遺伝子(CDx報告)-FFPE
			77481	オンコメインマルチCDx 8遺伝子(CDx、未承認報告) -FFPE
			13956	(Amoy Dx®)肺癌マルチ遺伝子 PCRパネル 7遺伝子-FFPE

●代替項目なし

受託中止項目			関連項目	
依頼コードNo.	検査項目名	中止理由	依頼コードNo.	検査項目名
13228	尿中シュウ酸	受託数僅少のため	-	なし
00499	アルドラーゼ(ALD)	測定試薬販売中止のため		
00430	イオン化カルシウム	受託数僅少のため	00427	カルシウム(Ca)
03546	HDL _{2,3} コレステロール		12958	リボ蛋白分画/HPLC法
07401	リボ蛋白脂質分画定量			
07402	リボ蛋白コレステロール分画定量			
07403	リボ蛋白トリグリセライド分画定量			
07404	リボ蛋白リン脂質分画定量		-	なし
04925	コレステリルエステル転送蛋白 (CETP)定量/EIA			
04432	可溶性ICAM-1			